

Характеристики контрольных точек

Обоз- начен- ие	Напряжение постоянное	Напряжение переменное	Измеряется относительно ноль-провода
А	$+35В \pm 5\%$	50 мВ макс	Д
Б	$+16В \pm 10\%$	3 мВ макс	Д
Г	$+16,5В \pm 10\%$	3 мВ макс	Д

Измерения производятся при напряжении сети 220В и номинальных токах нагрузки источников вольтметрами типа М 106 и ВЗ-7 или аналогичными им

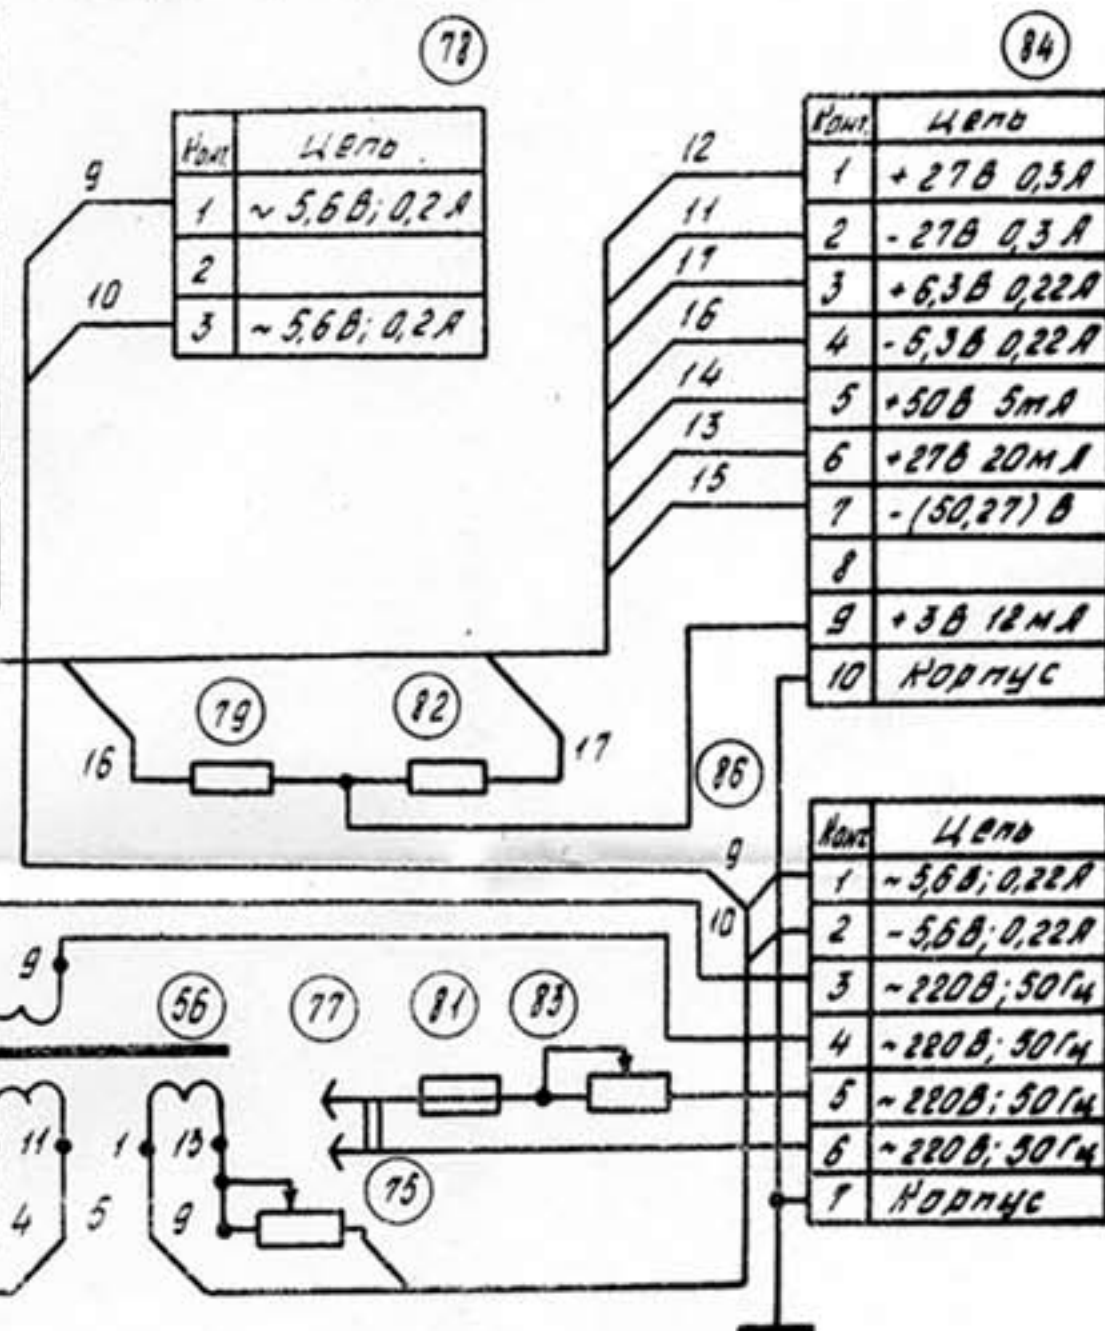
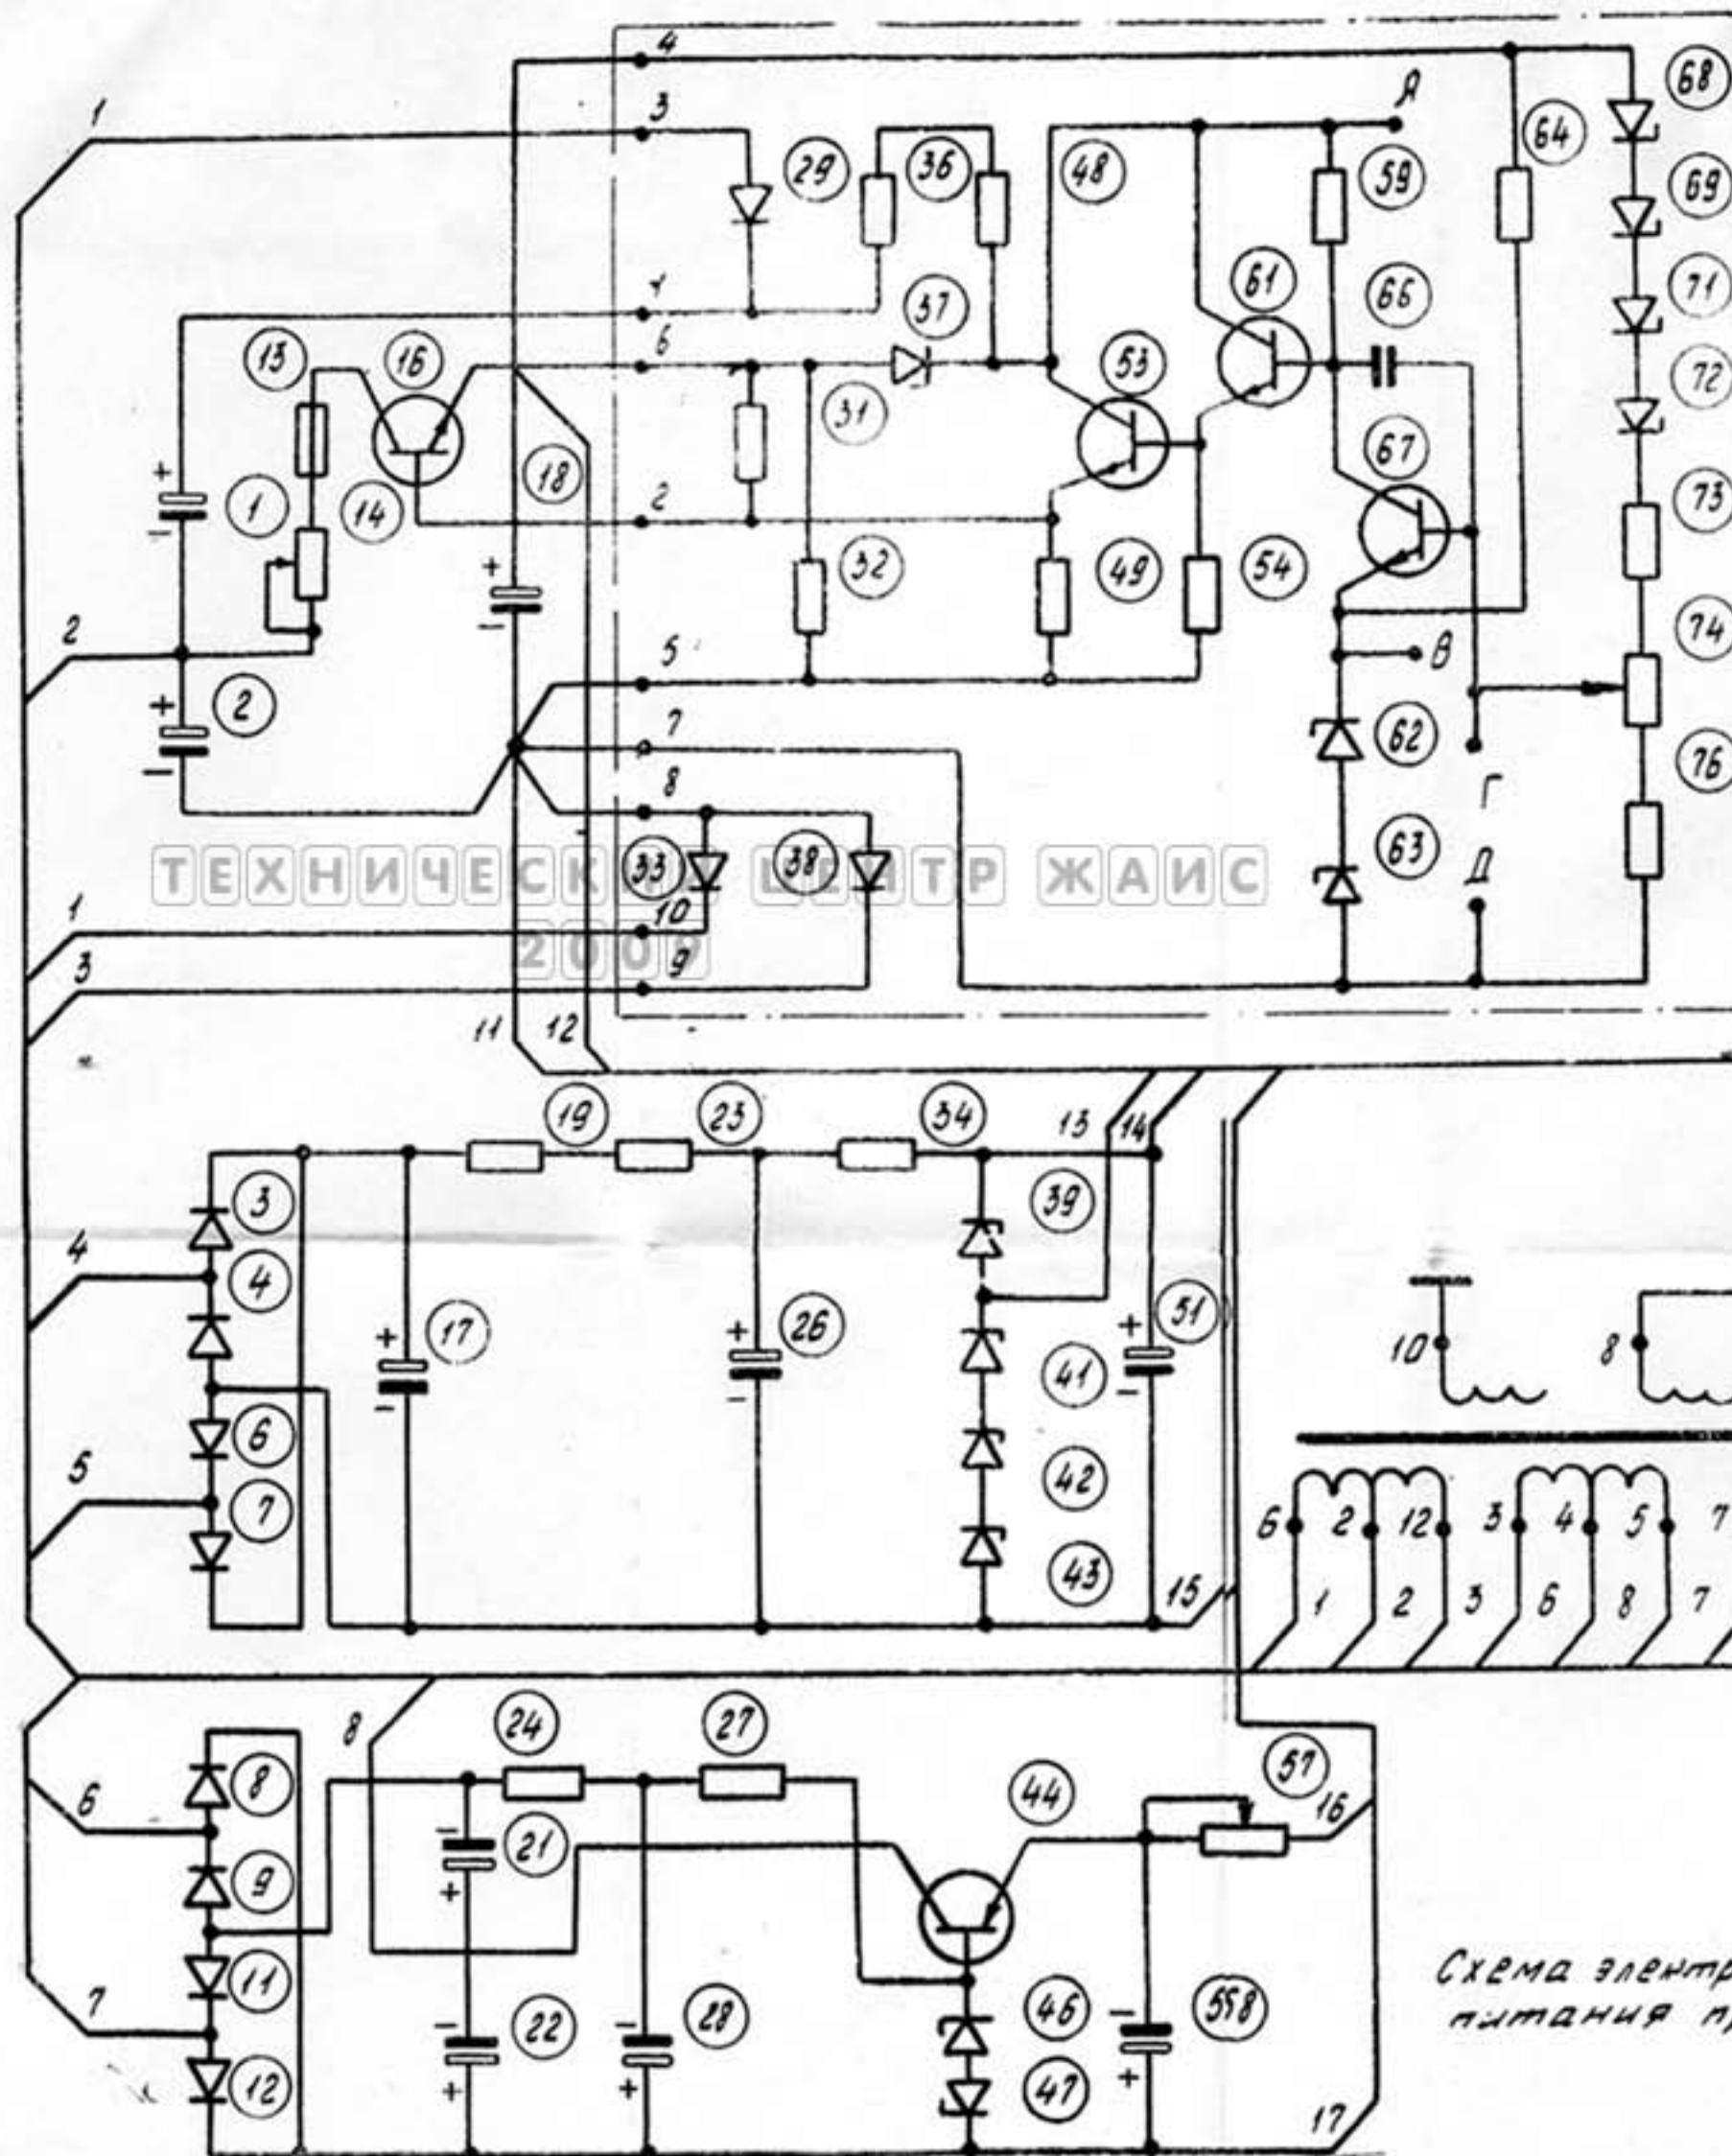


Схема электрическая принципиальная блока питания прибора Е4-10